




FÖRBEREDELSE

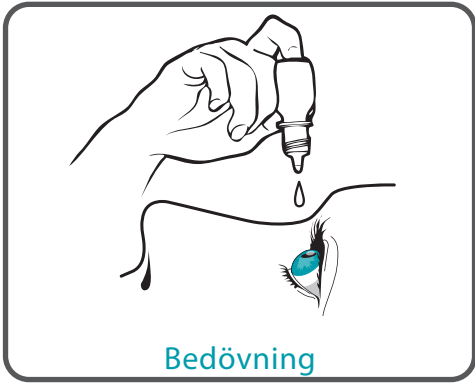

30 sek

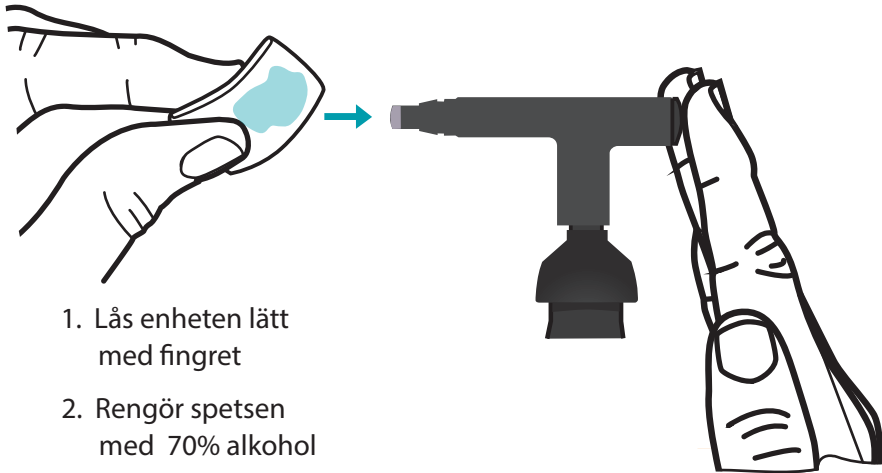


1. Lås enheten lätt med fingret
2. Rengör spetsen med 70% alkohol

# SNABB GUIDE



**BIGE** BioResonator  
Good Eye

**ART** Manual




STARTA ENHET

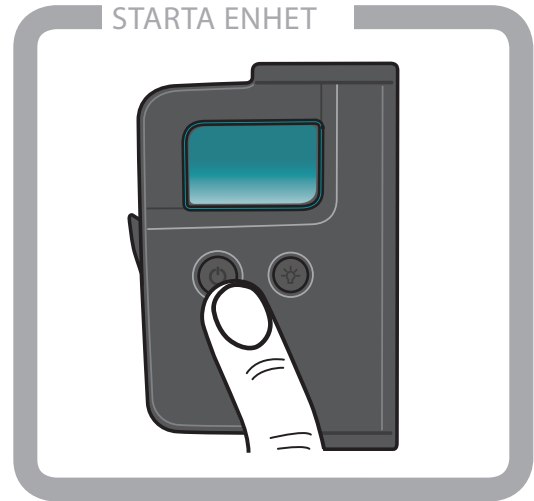

MÄTNING

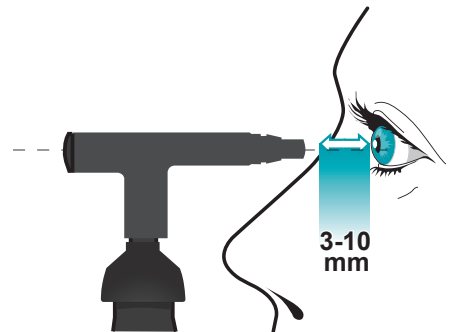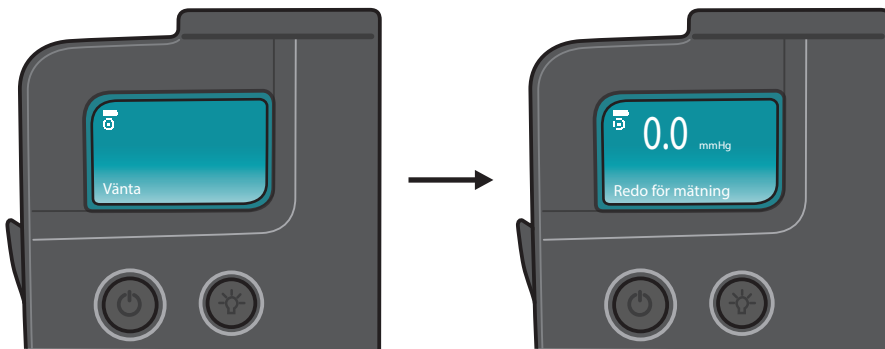

3 → 6 UPPREPNINGAR

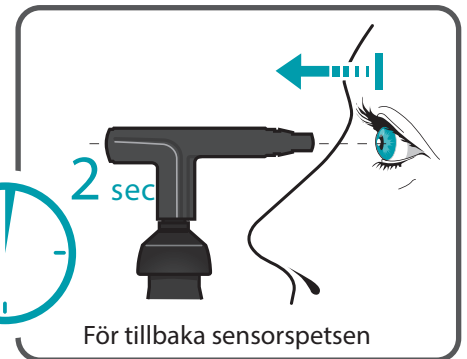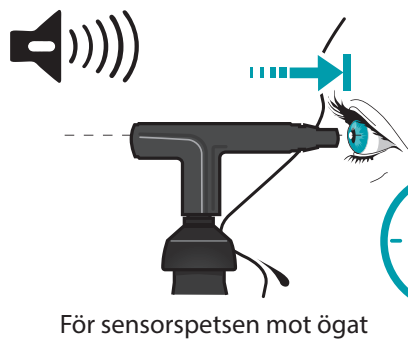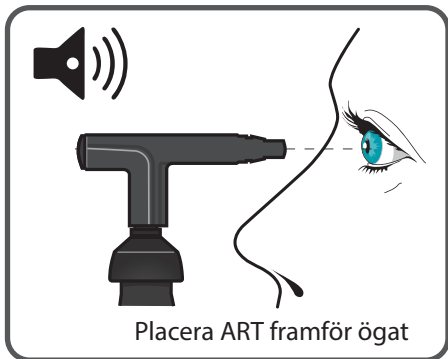

Q1 = 😊  
Utmärkt

Q2 = 😊  
Ok

Q3 = 😐  
Inte ok

